PEDIDO DE COMPRA Nº 03637

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE PROGRAMACION
25 JUL. 2012
RECIBIDO 2
HORA: 2:15
FIRMA:

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - NIÑO
Entregar a Sr(a) : LITUMA AGUIRRE DORIS MARSELA
Fecha : 05/07/2012
Tarea : P0248 REUNION PARA LA VALIDACION DE NORMAS TECNICAS NEONATALES
Motivo : REF NOTA INF N° 256/2012/DAIS/DGSP/MINSA - 12-061704-001

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0104	20	043	0093	0002	3033287	5000038

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
317500100058	MANIQUI PEDIATRICO PARA ENSEÑANZA	2.3. 1 99. 1 99	1.00	UNIDAD

PRODUCTO: SIMULADOR CON ACCESORIOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ASFIXIA.

- CANTIDAD: 350 KITS DE SIMULADOR, CON ACCESORIOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN REANIMACION DEL RECIEN NACIDO CON ASFIXIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS

1.- MANIQUÍ DE RECIÉN NACIDO:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INSTRUMENTO PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA ATENCIÓN ESTÁNDAR DEL RECIÉN NACIDO Y LAS MEDIDAS DE REANIMACIÓN.

DEBE TENER UN TAMAÑO REAL Y LA APARIENCIA DE UN RECIÉN NACIDO NORMAL, SU COLOR SE DEBE SEMEJAR AL COMÚN DEL NIÑO LATINO, ASÍ MISMO SU DISEÑO, MATERIAL Y ESTRUCTURA DEBE PERMITIR SIMULAR DE MANERA NATURAL EL PESO, LA TEXTURA, FLEXIBILIDAD Y TEMPERATURA DE UN RECIÉN NACIDO.

DEBE CONTAR CON ADITAMENTOS (BOMBILLAS, TUBOS, CONECTORES, Y OTROS) QUE PERMITAN SIMULAR: LOS GRITOS DE NACIMIENTO, RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA Y EL PULSO PALPABLE UMBILICAL.
EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEBE SER DURABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

2.- ACCESORIOS.

"UN RESUCITADOR MANUAL COMPUESTO POR UNA BOLSA, VÁLVULA Y MASCARILLA DE SILICONA Y DE POLISULFONATO, CON UNA MASCARILLA ADICIONAL, LAS MASCARILLAS DEBE TENER UN TAMAÑO ADECUADO PARA UN RECIÉN NACIDO NORMAL N° 1 Y PREMATURO N° 2, SU DISEÑO DEBE PERMITIR UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.

"UN INSTRUMENTO DE ASPIRACIÓN DE UNA SOLA PIEZA, DE SILICONA, SU DISEÑO DEBE FACILITAR LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DEL RECIÉN NACIDO POR VÍA ORAL Y NASAL Y SU POSTERIOR VACIAMIENTO Y LIMPIEZA.
"UN ESTETOSCOPIO.
"UNA BOLSA DE TELA IMPERMEABLE PARA TRANSPORTE.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

SET QUE INCLUYE UN MANIQUÍ, ACCESORIOS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SU USO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN EN ESPAÑOL.

3.- CONTROL DE CALIDAD

EL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS QUE RIGEN PARA ESTE TIPO DE PRODUCTOS.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud de las Personas
Dra. DORIS LITUMA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL
Firma del Solicitante

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud de las Personas
Dra. DORIS LITUMA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL
Firma Autorizada

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud de las Personas
Área Administrativa

47
4

FICHA TECNICA

Producto: ***Simulador con accesorios para capacitar al personal de salud en reanimación del recién nacido con asfixia.***

1.- Especificaciones Técnicas:

1.- Maniquí de recién nacido:

Instrumento para facilitar el aprendizaje de la atención estándar del recién nacido y las medidas de reanimación.

Debe tener un tamaño real y la apariencia de un recién nacido normal, su color se debe semejar al común del niño latino, así mismo su diseño, material y estructura debe permitir simular de manera natural el peso, la textura, flexibilidad y temperatura de un recién nacido.

Debe contar con aditamentos (bombillas, tubos, conectores, y otros) que permitan simular: Los gritos de nacimiento, respiración espontánea y el pulso palpable umbilical.

El material de fabricación debe ser durable y de fácil limpieza y conservación.

2.- Accesorios.

- Un resucitador manual compuesto por una bolsa, válvula y mascarilla de silicona y de polisulfonato, con una mascarilla adicional, las mascarillas debe tener un tamaño adecuado para un recién nacido normal N° 1 y prematuro N° 2, su diseño debe permitir una fácil limpieza y conservación.
- Un instrumento de aspiración de una sola pieza, de silicona, su diseño debe facilitar la aspiración de secreciones del recién nacido por vía oral y nasal y su posterior vaciamiento y limpieza.
- Un estetoscopio.
- Una bolsa de tela impermeable para transporte.

Forma de Presentación: Set que incluye un maniquí, accesorios y manual de instrucciones para su uso, limpieza y conservación en español.

3.- Control de Calidad

El producto deberá estar fabricado en concordancia con los dispositivos que rigen para este tipo de productos.

MINISTERIO DE SALUD · Dirección de Atención Integral de Salud

SIMULADOR PARA CAPACITAR EN REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ASFIXIA – KIT

1. MANIQUI

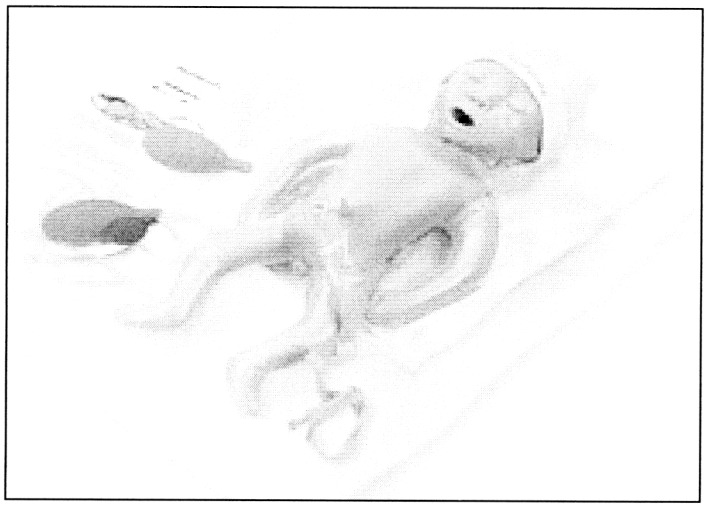

2. ACCESORIOS

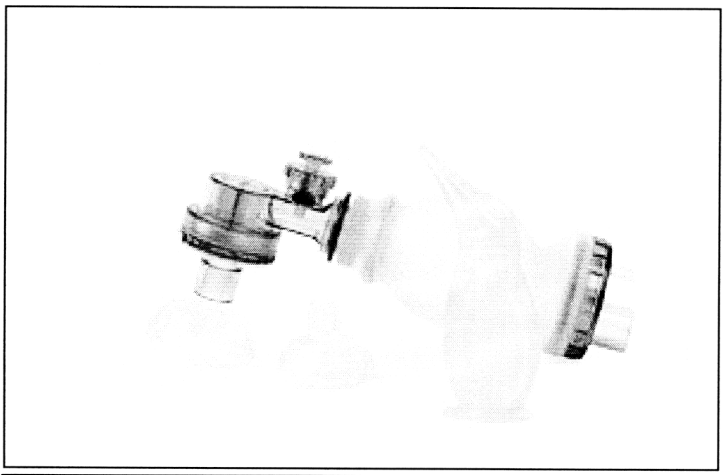

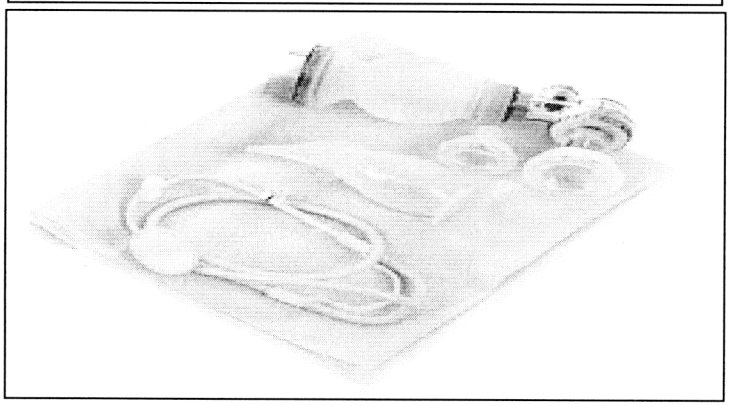

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Atención Integral de Salud

45
2